

Рекомендованный прайс-лист



10.06.2026



Прайс-лист содержит рекомендованные цены поставки для государственных и муниципальных нужд Российской Федерации. Указанная стоимость носит справочный характер и может быть использована для формирования начальной максимальной цены контракта только после официального подтверждения состава поставки, набора комплектующих и необходимых аксессуаров.



Транспортный аппарат искусственной вентиляции лёгких Zisline T100

Аппарат поддерживает современную концепцию сохранения собственного дыхания на всех этапах ИВЛ.

Взрослые

Дети

Новорождённые

Новорождённые с ЭНМТ от 500 г

Инвазивная и неинвазивная искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) у взрослых, детей и новорождённых, в том числе с экстремально низкой массой тела от 500 г.

- Дисплей 10.1", сенсорный, цветной
- Встроенный аккумулятор: до 8 часов работы
- Частота дыхания: 1–120 дых./мин – взрослые, дети; 1–150 дых./мин – новорождённые

Области применения

В отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, а также при транспортировке пациентов, в условиях стационара медицинского учреждения, в полевых и мобильных госпиталях экстренных служб.

Вне медицинской организации, при оказании экстренной или неотложной медицинской помощи.

В транспортном средстве при санитарно-авиационной медицинской эвакуации, осуществляемой воздушными судами.

В транспортном средстве при санитарной медицинской эвакуации, осуществляемой наземным, водным и другими видами транспорта.



Тренды

Сохранение и просмотр трендов основных параметров мониторинга в объёме последних 360 часов.

Режимы вентиляции

Режимы принудительной ИВЛ	С управляемым объёмом С управляемым давлением С управлением по давлению и доставкой гарантированного объёма	CMV VCV CMV PCV PCV VG	Взрослые, дети
Режимы синхронизированной перемежающейся ИВЛ	С управляемым объёмом и поддержкой давлением спонтанных вдохов С управляемым давлением и поддержкой давлением спонтанных вдохов С потоковым триггером и триггером по давлению с двойным контролем	SIMV VC SIMV PC SIMV DC	Взрослые, дети
Режимы самостоятельного дыхания	С постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением	CPAP+PS	Взрослые, дети
	С постоянным положительным давлением с возможностью поддержки объёмом	CPAP+VS	Взрослые, дети
	Вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях	APRV	Взрослые, дети
	Самостоятельное дыхание с двумя уровнями постоянного положительного давления с возможностью поддержки давлением	BiSTEP	Взрослые, дети
	Неинвазивная вентиляция	NIV	Взрослые, дети

Резервный режим	Апноэ-вентиляция	Apnea	Взрослые, дети
Высокопоточная кислородная терапия	Высокопоточная вентиляция	HF_O ₂	Все группы
Адаптивная вентиляция	Интеллектуальная адаптивная вентиляция с автоматическим поддержанием заданной минутной вентиляции и поддержкой принудительной и вспомогательной вентиляции в зависимости от респираторной активности пациента	iSV	Взрослые, дети
Функция	Функция поддержки давлением	PS	Взрослые, дети
Специализированные неонатальные режимы	Неинвазивная респираторная поддержка постоянным положительным давлением	nCPAP	Новорождённые
	Неинвазивная перемежающаяся вспомогательная вентиляция лёгких с управлением по давлению вдоха и поддержкой давлением спонтанных вдохов	nIMV	Новорождённые

	K0.26	K1.26	K2.26
CMV VCV	+	+	+
CMV PCV	+	+	+
SIMV VC	+	+	+
SIMV PC	+	+	+
SIMV DC	+	+	+
CPAP+PS	+	+	+
CPAP+VS	+	+	+
BiSTEP	+	+	+
NIV	+	+	+
APRV	+	+	+
PCV VG	+	+	+
iSV	по запросу	+	+
HF_O ₂	по запросу	+	+
nCPAP			+
nIMV			+
Apnea	+	+	+

Параметры вентиляции

	K0.26	K1.26	K2.26
Дыхательный объем, мл	20–3000	20–3000	2–3000
Время вдоха, с	0.2–15	0.2–15	0.2–15
Давление вдоха, см вод. ст.	0–100	0–100	0–100
Чувствительность триггера по потоку, л/мин	0.5–20	0.5–20	0.1–20
Чувствительность триггера по давлению, см вод. ст.	0.5–20	0.5–20	0.5–20
Положительное давление в конце выдоха, см вод. ст.	0–50	0–50	0–50

Дополнительные функции, оснащение

	K0.26	K1.26	K2.26
Модуль капнометрии в прямом потоке	+	+	+
Объёмная капнометрия (VCO ₂), мониторинг параметров альвеолярной вентиляции	+	+	+
Стресс-индекс	+	+	+
Расчет сердечного выброса по Фику (CO)		+	+
Модуль дополнительного давления (P _{aux})			+
Модуль пульсоксиметрии		+	+
Модуль потока внешний			+
Тележка транспортная	110 000	110 000	110 000
Кислородный баллон с креплением	200 000	200 000	200 000
Комплект зарядного устройства	33 000	33 000	33 000
Дополнительный аккумулятор	9 000	9 000	9 000
Сумка транспортная	30 000	30 000	30 000
Ремень плечевой	3 000	3 000	3 000
Устройство крепления в автомобиле СМП	13 000	13 000	13 000
Устройство крепления в санавиации	16 000	16 000	16 000
Устройство крепления на стену	50 000	50 000	50 000
Гарантийный период — 24 месяца	+	+	+
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учета расходных материалов	180 000	180 000	180 000
Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория	1 475 000 / 1	1 950 000 / 2	2 840 000 / 2

Аппарат искусственной вентиляции лёгких стационарный Zisline MV350

Аппарат поддерживает современную концепцию сохранения собственного дыхания пациента на всех этапах ИВЛ.

Взрослые Дети Новорождённые

Новорождённые с ЭНМТ от 500 г

Zisline MV350 — многофункциональный аппарат ИВЛ для проведения управляемой и вспомогательной вентиляции у всех групп пациентов, включая новорождённых с экстремально низкой массой тела. Предназначен для эксплуатации в отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии, а также при транспортировке в пределах ЛПУ.

Аппарат не зависит от источников сжатого воздуха — имеет встроенную малошумную турбину с быстрым временем отклика.

- Дисплей 15", сенсорный, цветной, с регулировкой угла наклона
- Встроенный аккумулятор: не менее 4 часов работы
- Дыхательный объём: 1–3000 мл
- Частота дыхания: 1–150 дых./мин
- Чувствительность триггера по потоку: 0.1–20 л/мин
- Чувствительность триггера по давлению: 0.5–20 см вод. ст.



Режимы вентиляции

Режимы принудительной ИВЛ	С управляемым объёмом С управляемым давлением С управлением по давлению и доставкой гарантированного объёма	CMV VCV CMV PCV PCV VG	Все группы пациентов
Режимы синхронизированной перемежающейся ИВЛ	С управляемым объёмом и поддержкой давлением спонтанных вдохов С управляемым давлением и поддержкой давлением спонтанных вдохов С управлением по давлению и доставкой гарантированного объёма (с двойным контролем)	SIMV VC SIMV PC SIMV DC	Все группы
Режимы самостоятельного дыхания	С постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением	CPAP+PS	Все группы
	С постоянным положительным давлением с возможностью поддержки объёмом	CPAP+VS	Все группы
	Самостоятельное дыхание с двумя уровнями постоянного положительного давления	BiSTEP	Взрослые, дети
	Вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях	APRV	Взрослые, дети

Режимы вентиляции

Режимы самостоятельного дыхания	Неинвазивная вентиляция	NIV	Взрослые, дети
	Насальная вентиляция с постоянным положительным давлением	nCPAP	Новорождённые
	Неинвазивная перемежающаяся вспомогательная вентиляция с управлением по давлению вдоха и поддержкой давлением спонтанных вдохов	nIMV	Новорождённые
Адаптивная вентиляция	Интеллектуальная адаптивная вентиляция с автоматическим поддержанием заданной минутной вентиляции и автоматическим подбором параметров вентиляции в зависимости от респираторной активности пациента	iSV	Взрослые, дети
Резервный режим	Апноэ-вентиляция	Apnea	Все группы
Высокопоточная кислородная терапия	Непрерывный поток подогретой и увлажнённой газовой смеси с заданной концентрацией кислорода	HF_O ₂	Все группы

Базовый мониторинг


- Максимальное давление на вдохе, давление плато, среднее давление, PEEP, AutoPEEP.
- Минутный объём дыхания, в том числе спонтанного дыхания.
- Объём вдоха, объём выдоха.
- Время выдоха, в том числе спонтанного.
- Величина потока в конце выдоха.
- Максимальный поток на вдохе.
- Величина утечки на вдохе и на фазе PEEP.
- Частота дыханий, частота спонтанных вдохов.
- Комплаинс C и резистанс R.
- Динамический комплаинс / резистанс.
- Длительность вдоха и выдоха.
- Коэффициент заполненности цикла дыхания (отношение времени вдоха к общей длительности дыхательного цикла).
- Отношение времени вдоха к времени выдоха I:E.
- Концентрация кислорода на вдохе FiO₂.
- Содержание CO₂ в газовой смеси EtCO₂, FiCO₂.

Графический мониторинг

Одновременное отображение на экране до трёх кривых и одной петли по выбору пользователя. Запоминание референтной (опорной) петли. Кривые: поток-время, давление-время, объём-время, капнограмма (PCO₂-время), SpO₂, график режима iSV, VCO₂, P_{aux}. Петли: объём-поток, объём-давление, поток-давление, объём-дополнительное давление.

Расширенный мониторинг

- Конечное давление выдоха.
- Внутреннее положительное давление в конце выдоха (остаточное давление в лёгких, возникающее вследствие незавершённости выдоха).
- Временная константа на вдохе, временная константа на выдохе.
- Стресс-индекс.
- Индекс респираторного усилия (P0.1).
- Работа дыхания пациента, работа дыхания аппарата.
- Коэффициент спонтанного дыхания.
- Сопротивление выдоху.
- Сопротивление контура.
- Растяжимость контура.
- Эластичность дыхательных путей (эластенс).
- Индекс поверхностного дыхания.
- Объём минутной альвеолярной вентиляции (MV_{alv}).
- Дополнительное давление (P_{aux}) в трахее/пищевode.
- Функциональное «мёртвое» пространство.
- Сердечный выброс (CO).
- Потребление кислорода (VO₂).
- Элиминация (выделение) CO₂.
- Коэффициент дыхания (RQ).
- Расход энергии (EE).
- Уровень оксигенации гемоглобина артериальной крови (SpO₂).
- Частота пульса (PR).

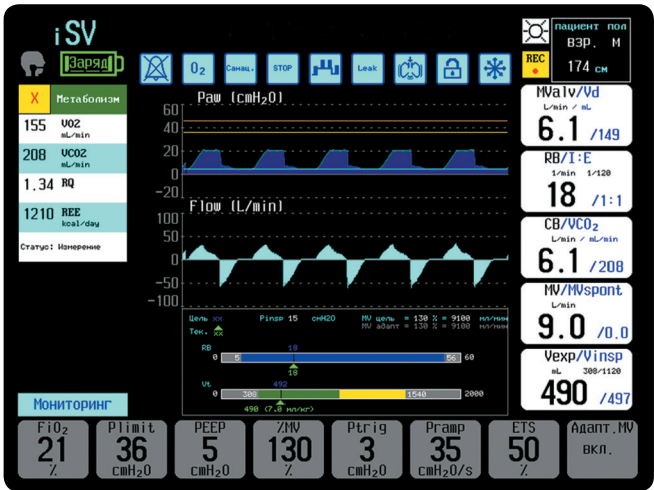

Возможности аппарата

Вентиляция новорождённых	Для проведения ИВЛ у новорождённых аппарат способен проводить вентиляцию малыми дыхательными объёмами. Аппарат рассчитан на работу с распространёнными стандартными одноразовыми дыхательными контурами для nCPAP-терапии, с назальными канюлями и с назальными масками В аппарате есть режим неинвазивной вентиляции лёгких (nCPAP) у неонатальных пациентов, который предназначен для создания постоянного положительного давления (CPAP) в дыхательных путях новорождённых и детей массой менее 5 кг В дыхательных путях пациента создаётся заданный врачом уровень давления, помогающий новорождённым с различными респираторными заболеваниями, включая респираторный дистресс-синдром Режим неинвазивной вентиляции nIMV добавляет к постоянному положительному давлению автоматические дыхательные циклы. В этом режиме предусмотрены настраиваемые тревоги по слишком высокому давлению или по слишком низкому давлению в проксимальном отделе дыхательного контура
Проксимальный датчик потока	Для обеспечения высокой точности измерения малых дыхательных объёмов в аппарате применяется проксимальный датчик потока. Это решение обеспечивает эффективность мониторинга и управления параметрами механической вентиляции у неонатальных пациентов, делая её максимально безопасной Zisline MV350 блокирует другие режимы, если подключён проксимальный датчик потока, сохраняя врачу время для манёвра в принятии клинических решений
Высокопоточная кислородная терапия	Режим высокопоточной кислородной терапии предназначен для вентиляции лёгких для пациентов со спонтанным дыханием, с использованием назальной канюли. В режиме пациенту подаётся непрерывный поток подогретой и увлажнённой газовой смеси с заданной концентрацией кислорода
Микропомповый небулайзер	Для работы в неонатальном режиме рекомендуется микропомповый небулайзер, не вносящий дополнительный поток. Такой небулайзер не требует синхронизации с аппаратом и работает независимо
Режим вентиляции iSV	Режим интеллектуальной адаптивной вентиляции обеспечивает целевой объём минутной вентиляции независимо от спонтанной дыхательной активности пациента. Кроме того, режим iSV автоматически регулирует уровень давления поддержки после каждого дыхательного цикла Преимущества адаптивной вентиляции iSV: автоматическая регулировка отношения I:E в реальном времени в соответствии с механикой дыхания пациента; автоматический расчёт статических и динамических пределов безопасной вентиляции дыхательного объёма, частоты дыхания и I:E обеспечивает строгое соответствие параметров вентиляции заданным ограничениям Режим оптимален при быстроизменяющихся дыхательных потребностях пациента, например, во время отлучения от респиратора. Режим адаптивной вентиляции не исключает участия врача в настройке параметров, но существенно облегчает его работу и минимизирует время оптимизации параметров
Объёмная капнометрия VCO ₂	Измерение и графическое отображение концентрации CO₂ в выдыхаемом газе стало стандартной практикой в анестезиологии и реаниматологии. Капнография отражает адекватность вентиляции, газообмена, выделения CO₂ и сердечного выброса, оценивает положение интубационной трубки. Данный метод мониторинга рекомендован для использования в палатах интенсивной терапии и операционных с целью повышения безопасности пациентов, а также необходим пациентам с повышенным внутричерепным давлением Дополнительные возможности VCO₂: позволяет оценить альвеолярную вентиляцию; отслеживает изменение физиологического «мёртвого» пространства в процессе искусственной вентиляции
Оценка метаболических потребностей пациента	Метод непрямой калориметрии считается «золотым стандартом» метаболического мониторинга. Помимо непосредственного измерения действительного расхода энергии (REE), данный метод позволяет рассчитать дыхательный коэффициент (RQ) — отношение скорости выделения диоксида углерода к скорости потребления кислорода, а также оценить вклад каждого макронутриента в общий метаболизм Принцип работы метаболога основан на измерении объёма выделенного углекислого газа, объёма поглощённого кислорода и последующем расчёте энергозатрат с использованием уравнения Вейра Встроенный метаболог удобен и прост для применения и требует минимум действий

Возможности Zisline MV350

Канал дополнительного давления P_{aux}	Среди основных принципов протективной ИВЛ важным компонентом для предупреждения ателектотравмы считается правильно установленный уровень PEEP Канал дополнительного давления позволяет получить ценную для практикующего врача информацию. Он позволяет измерять давление в трахее и пищеводе. Давление в пищеводе приравняется к внутриплевральному $P_{\text{транспульмональное}} = P_{\text{альвеолярное}} - P_{\text{плевральное}}$ Транспульмональное давление — единственный объективный критерий для настройки PEEP
Сердечный выброс (непрямой метод Фика)	Определение сердечного выброса играет важную роль как для ведения пациента во время анестезии, так и при проведении мероприятий интенсивной терапии: начиная от оценки предсказуемых изменений во время индукции и заканчивая мониторингом при обширных вмешательствах или интенсивной терапии. Поскольку механическая вентиляция всегда оказывает влияние на гемодинамику пациента, мониторинг центральной гемодинамики у пациентов на ИВЛ способствует более адекватной оценке состояния Непрямой метод Фика — один из способов мониторинга сердечного выброса. В нём используются данные объёмной капнометрии, получаемые аппаратом ИВЛ, и парциальное давление CO_2 венозной крови, полученное лабораторным путём, которое вводится врачом вручную в поле калькулятора сердечного выброса

Режимы вентиляции

		K0.26	K1.26	K2.26	K3.26
Режимы принудительной ИВЛ	CMV VCV, CMV PCV, PCV VG	+	+	+	+
Синхронизированные перемежающиеся режимы ИВЛ	SIMV VC, SIMV PC, SIMV DC	+	+	+	+
Режимы самостоятельного дыхания	CPAP+PS, CPAP+VS, BiSTEP, APRV, NIV	+	+	+	+
	nCPAP, nIMV			+	+
Адаптивная вентиляция	iSV	по запросу	по запросу	+	+
Функция поддержки давлением	PS	+	+	+	+
Высокопоточная кислородная терапия	HF_O ₂	+	+	+	+

Дополнительные функции, оснащение

	K0.26	K1.26	K2.26	K3.26
Модуль капнометрии в прямом потоке	+	+	+	+
Модуль газоанализа с функцией оценки метаболизма		+	+	+
Объёмная капнометрия (VCO ₂), мониторинг параметров альвеолярной вентиляции и сердечного выброса (по Фику)		+	+	+
Модуль дополнительного давления (P _{aux}) в трахее или пищеводе с помощью катетера, кривая P _{aux}				+
Модуль пульсоксиметрии	по запросу	по запросу	+	+
Увлажнитель с сервоконтролем			+	+
Небулайзер пневматический	+	+	+	+
Небулайзер микропомповый				+
Комплектация для проведения ИВЛ в специализированных неонатальных режимах			+	+
Гарантийный период — 24 месяца	+	+	+	+
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов	180 000	180 000	180 000	180 000
Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория	1 980 000 / 1	2 900 000 / 2	3 640 000 / 2	3 980 000 / 2

Zisline MV350

Аппарат искусственной вентиляции лёгких высокочастотный струйный Zisline JV100

- Дисплей 12.1", сенсорный, цветной, с регулировкой угла наклона
- Смеситель газов и управление FiO₂
- Модуль капнографии в прямом потоке
- Встроенный аккумулятор: не менее 1 часа работы
- Газоснабжение дыхательной смесью: кислород — от центральной газовой сети, баллона; воздух — от центральной газовой сети или компрессора
- Система полноценного кондиционирования дыхательной смеси (автоматические подогрев с термоконтролем и увлажнение)

Высокочастотная струйная вентиляция лёгких (high frequency jet ventilation) — это вентиляция малыми (100–200 мл) дыхательными объёмами с частотой, превышающей 60 циклов в минуту.

Предназначен для проведения струйной высокочастотной вентиляции лёгких у взрослых и детей с массой тела не менее 15 кг в условиях стационара с расширенным мониторингом параметров ИВЛ и пациента.

Взрослые

Дети > 15 кг



Параметры вентиляции

Регулировка FiO ₂ в безынжекционном и катетерном режимах, %	21–100
Частота дыхания, дых./мин	30–300
Минутный объём вентиляции (инжекционный и безынжекционный), л/мин	5–30
Минутный объём вентиляции (катетерный режим), л/мин	3–20
Отношение продолжительности вдоха к продолжительности выдоха I:E	1:3; 1:2; 1:1; 3:2; 2:1

Дополнительные возможности

- Функция лёгочной перкуссии.
- Функция экспираторной паузы.
- Функция оксигенации.

Мониторинг параметров вентиляции

- Минутный объём вентиляции.
- Объём вдоха.
- Положительное давление конца выдоха.
- Пиковое давление в дыхательных путях.
- Среднее давление в дыхательных путях.

Графическое отображение

- Давление-время.
- Капнограмма.

Гарантийный период — 24 месяца	+
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов	180 000
Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория	3 280 000 / 2

Анализатор мультигазовый АМГ-06

- Взрослые
- Дети
- Новорождённые



Анализатор АМГ-06 предназначен для непрерывного неинвазивного мониторинга концентрации ингаляционных анестетиков: изофлюрана (Iso), севофлюрана (Sev), десфлюрана (Des), галотана (Hal), энфлюрана (Enf), а также закиси азота N₂O, углекислого газа CO₂ на вдохе и на выдохе.

Работа в боковом потоке. Минимальный отбор пробы — 70 мл/мин.

Дополнительное определение частоты дыхания пациента (RSP) и апноэ, минимальной альвеолярной концентрации (коэффициент МАК).

Выбор анестетика выполняется вручную, анализатор проводит автоматическую детекцию неверного выбора.

- Дисплей 120 мм, сенсорный, цветной
- Встроенный аккумулятор: не менее 2 часов работы
- Тренды: графические, до 72 часов
- Система тревог: визуальная и звуковая сигнализация
- Крепление: крепёж-тиски для установки в подвешном виде

Преимущества

Эргономичный дизайн	Прибор компактный, имеет небольшую массу Может размещаться на рабочей поверхности или фиксироваться с помощью крепления-тисков
Простота в эксплуатации	Понятный интерфейс, сенсорный дисплей Оптимальный набор необходимых функций Используется совместно с электрохирургическим инструментом Совместим с внешней информационной системой, оснащён Wi-Fi
Безопасность для пациента	Точное измерение концентрации позволяет проводить безопасное анестезиологическое пособие, особенно когда используется метод низкпоточной анестезии
Аксессуары	Стандартные расходные материалы

Особенности

Применение	Анестезиология, седация ингаляционными анестетиками в палате интенсивной терапии и реанимации
Категории пациентов	Прибор предназначен для пациентов всех возрастных групп
Измеряемые газы	Изофлюран (Iso), севофлюран (Sev), десфлюран (Des), галотан (Hal), энфлюран (Enf), закись азота N ₂ O, углекислый газ CO ₂
Принцип работы	Неинвазивный, отбор пробы в боковом потоке Метод недисперсионной инфракрасной спектроскопии (НДИС) — измерение степени поглощения инфракрасных лучей при их прохождении через газовый поток

Гарантийный период — 24 месяца	+
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов	48 000
Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория	590 000 / 2

АМГ-06



Монитор оценки глубины анестезии МГА-06

Взрослые

Дети > 10 лет



Специализированный одноканальный монитор предназначен для оценки и длительного мониторинга глубины анестезии и седации пациента.

Во время проведения операций, в подготовительном и послеоперационном периоде. При проведении инвазивных диагностических вмешательств и интенсивной терапии при анестетическом или седативном воздействии. Для получения объективной информации о глубине седации при проведении медицинских манипуляций на фоне медикаментозной комы (черепно-мозговые травмы, судорожный синдром).

Применяется в анестезиологии, реаниматологии, интенсивной терапии, во время послеоперационного периода, процедурной седации, а также в случаях применения анестетиков общего действия.

- Дисплей 5", сенсорный, цветной
- Встроенный аккумулятор: не менее 2 часов работы
- Тренды: графические, до 72 часов
- Система тревог: визуальная и звуковая сигнализация
- Крепление: крепёж-тиски для установки в подвесном виде
- Масса прибора: 0.8 кг

Преимущества

Универсальность	Монитор работает с ингаляционными и внутривенными анестетиками
Экономичность	Измерение производится с помощью одноразовых ЭКГ-электродов (комплект из трёх стандартных ЭКГ-электродов на одно измерение)
Эффективность	Применение монитора МГА-06 позволяет: уменьшить расход анестетиков, а также снизить время выхода из наркоза на 35–50%; стабильно поддерживать требуемую глубину седации

Определяемые параметры

AI — индекс активности головного мозга	Оценка глубины анестезии производится на основании анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Алгоритм анализа ЭЭГ располагает информацией о типичных признаках воздействия разных групп анестетиков — видах угнетения ЭЭГ
SR (Supression rate) — коэффициент подавления сигнала ЭЭГ	Отражает общую длительность участков подавления по отношению к принятому интервалу и определяет степень дальнейшего углубления наркоза
SQL — индекс качества сигнала	Рассчитывается по значениям импедансов электродов кабеля ЭЭГ, наличию в составе ЭЭГ помех от артефактов, высокочастотных помех, сетевой помехи
EMG — уровень электромиографической составляющей энцефалограммы	Вызывается электрической активностью мимических мышц. Уровень ЭМГ в графическом виде отображается в наиболее значимом клиническом диапазоне
Гарантийный период — 24 месяца	+
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов	48 000
Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория	395 000 / 2

МГА-06



Анестезиологический монитор пациента МПР6-03

Предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.



Взрослые

Дети

Новорождённые

A2.26

A3.26

Дисплей сенсорный, цветной		15"	15"
Аккумулятор. 2 часа работы		+	+
Тренды. 240 часов		+	+
Термопринтер. Печать до трёх кривых		+	+
USB, разъём Ethernet		+	+
Кронштейн для крепления мониторов		14 000	14 000
Комплект неонатальных расходных материалов		по запросу	по запросу
Электрокардиография (ЭКГ)	12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V ₁ -V ₆ Анализ variability сердечного ритма (BCP) Анализ ST-сегмента. Частота сердечных сокращений Анализ и автоматическое распознавание аритмии ЭКГ-кабель на пять электродов в комплекте	+	+
Пульсоксиметрия	Частота пульса. Насыщение артериальной крови кислородом (сатурация) SpO ₂ . Фотоплетизмограмма	+	+
Термометрия	Два канала. Измерение разности температур	+	+
Импедансный метод измерения параметров дыхания	ЧД. Респирограмма	+	+
НИАД	Сист / Сред / Диаст АД	+	+
Автоматическое внеочередное измерение АД (НИАД)	Сист / Сред / Диаст АД, время задержки волны ФПГ относительно QRS-комплекса ЭКГ	+	+
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики	CO, SV, CI, SI, SVR, LSP. Собственная технология, основанная на методе объёмно-компрессионной осцилометрии		+
Инвазивное измерение артериального давления (два канала ИАД)	Сист / Сред / Диаст АД. Выбор типа давления: ART, PA, CVP, ICP, RAP, LAP, RVP, UA. Кривые IBP1, IBP2	90 000	+
Капнография в прямом потоке	EtCO ₂ , FiCO ₂ , ЧД. Капнограмма		+
Калькулятор метаболических потребностей	VO ₂ , VCO ₂ , REE, RQ	+	+
Анализ анестезиологических газов (мультигаз)	Fi/Et: CO ₂ , O ₂ , N ₂ O, AA. ЧД, МАК Кривые на выбор: CO ₂ , O ₂ , любой анестетик	+	+
Глубина анестезии (уровень седации)	Индекс активности головного мозга AI Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), EMG, индекс качества сигнала	+	+
Гарантийный период — 24 месяца		+	+
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов		90 000	90 000
Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория		1 050 000 / 2	1 180 000 / 2

МПР6-03

Реанимационный монитор пациента

МПР6-03

Предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.



- Взрослые
- Дети
- Новорождённые

- Дисплей сенсорный, цветной
- Аккумулятор. 2 часа работы
- Тренды. 240 часов
- Термопринтер. Печать до трёх кривых
- USB, разъём Ethernet
- Кронштейн для крепления мониторов
- Комплект неонатальных расходных материалов

Электрокардиография (ЭКГ)	12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V ₁ –V ₆ . Анализ variability сердечного ритма (BCP). Анализ ST-сегмента. Частота сердечных сокращений. Анализ и автоматическое распознавание аритмии. ЭКГ-кабель на пять электродов в комплекте
Пульсоксиметрия	Частота пульса. Насыщение артериальной крови кислородом (сатурация) SpO ₂ . Фотоплетизмограмма
Термометрия	Два канала. Измерение разности температур
Импедансный метод измерения параметров дыхания	ЧД. Респирограмма
НИАД	Сист / Сред / Диаст АД
Автоматическое внеочередное измерение АД (нНИАД)	Сист / Сред / Диаст АД, время задержки волны ФПГ относительно QRS-комплекса ЭКГ
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики	CO, SV, CI, SI, SVR, LSP. Собственная технология, основанная на методе объёмно-компрессионной осцилометрии
Инвазивное измерение артериального давления (два канала ИАД)	Сист / Сред / Диаст АД. Выбор типа давления: ART, PA, CVP, ICP, RAP, LAP, RVP, UA. Кривые IBP1, IBP2
Капнография в прямом потоке	EtCO ₂ , FiCO ₂ , ЧД. Капнограмма
Гарантийный период — 24 месяца	
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов	

Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория

С 2023 года в мониторах МПР6-03 для ОРИИТ доступна возможность комплектации каналом мониторинга глубины седации.

Седация широко используется для синхронизации пациента с аппаратом ИВЛ, а также для выполнения разнообразных лечебных и диагностических процедур (перевязки, бронхоскопии и т.д.).

Мониторинг глубины седации обеспечивает:

- максимальную безопасность и эффективность проводимого анестезиологического пособия;
- снижение риска неблагоприятного влияния препаратов на организм;
- предупреждение интранаркозного пробуждения;
- экономии дорогостоящих препаратов.

				МПР6-03
P1.26	P2.26	P3.26	P4.26	
15"	15"	15"	15"	
+	+	+	+	
+	+	+	+	
40 000	40 000	40 000	40 000	
+	+	+	+	
14 000	14 000	14 000	14 000	
по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	
+	+	+	+	
+	+	+	+	
+	+	+	+	
+	+	+	+	
+	+	+	+	
+	+	+	+	
	+		+	
	90 000	90 000	+	
		+	+	
+	+	+	+	
90 000	90 000	90 000	90 000	
280 000 / 1	330 000 / 1	450 000 / 1	570 000 / 2	

Канал обеспечивает мониторинг индекса активности головного мозга AI путём анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ) пациента во временной и частотной областях с отображением следующих параметров:

- индекс активности головного мозга AI, отн. ед. 0–100, шаг 1;
- коэффициент подавления сигнала ЭЭГ (SR), % 0–100, шаг 1;
- индекс качества сигнала ЭЭГ (SQI), % 0–100, шаг 1;
- уровень электромиографической составляющей (EMG), дБ 0–100, шаг 1.

Для проведения измерения достаточно трёх стандартных ЭКГ-электродов.

Мониторы с каналом мониторинга глубины седации: P1.26C, P2.26C, P3.26C, P4.26C, P5.26C (стр. 15–16).



14

Реанимационный монитор пациента МПР6-03 с каналом мониторинга глубины седации

Предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.



- Взрослые
- Дети
- Новорождённые

- Дисплей сенсорный, цветной
- Аккумулятор. 2 часа работы
- Тренды. 240 часов
- Термопринтер. Печать до трёх кривых
- USB, разъём Ethernet
- Кронштейн для крепления мониторов
- Комплект неонатальных расходных материалов

Электрокардиография (ЭКГ)	12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V ₁ –V ₆ . Анализ вариабельности сердечного ритма (BCP). Анализ ST-сегмента. Частота сердечных сокращений. Анализ и автоматическое распознавание аритмии. ЭКГ-кабель на пять электродов в комплекте
Пульсоксиметрия	Частота пульса. Насыщение артериальной крови кислородом (сатурация) SpO ₂ . Фотоплетизмограмма
Термометрия	Два канала. Измерение разности температур
Импедансный метод измерения параметров дыхания	ЧД. Респирограмма
НИАД	Сист / Сред / Диаст АД
Автоматическое внеочередное измерение АД (нНИАД)	Сист / Сред / Диаст АД, время задержки волны ФПГ относительно QRS-комплекса ЭКГ
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики	CO, SV, CI, SI, SVR, LSP. Собственная технология, основанная на методе объёмно-компрессионной осцилометрии
Инвазивное измерение артериального давления (два канала ИАД)	Сист / Сред / Диаст АД. Выбор типа давления: ART, PA, CVP, ICP, RAP, LAP, RVP, UA. Кривые IBP1, IBP2
Капнография в прямом потоке	EtCO ₂ , FiCO ₂ , ЧД. Капнограмма
Капнография в боковом потоке	EtCO ₂ , FiCO ₂ , ЧД. Капнограмма
Оксиметрия в боковом потоке	EtO ₂ , FiO ₂
Непрерывный мониторинг метаболических потребностей (на основе данных модуля респираторной механики)	Автоматический расчёт по затратам кислорода и элиминации CO ₂ с учётом респираторной механики: VCO ₂ , VO ₂ , REE, RQ
Респираторная механика	PIP, PEEP, V _e , MV _e , графики потока и давления. Объёмная капнограмма
Глубина анестезии (уровень седации)	Индекс активности головного мозга AI. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), EMG, индекс качества сигнала

Гарантийный период — 24 месяца

Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов

Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория

P1.26C	P2.26C	P3.26C	P4.26C	P5.26C	МПР6-03
15"	15"	15"	15"	15"	
+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	
40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
+	+	+	+	+	
14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	
по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	
+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	
	+		+	+	
	90 000	90 000	+	+	
		+	+	+	
				+	
				+	
				+	
				+	
+	+	+	+	+	
+	+	+	+	+	
90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	
300 000 / 1	365 000 / 1	480 000 / 1	620 000 / 2	985 000 / 2	



Транспортный / портативный монитор пациента МПР6-03

Предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.

Взрослые

Дети

Новорождённые



T1.26

T2.26

Дисплей сенсорный, цветной		7"	7"
Аккумулятор. 2 часа работы		+	+
Тренды. 240 часов		+	+
Термопринтер. Печать до трёх кривых		40 000	40 000
USB, разъём Ethernet		+	+
Кабель для подключения к бортовой сети 12 В		2 400	+
Комплект неонатальных расходных материалов		по запросу	по запросу
Кронштейн для крепления мониторов		14 000	14 000
Электрокардиография (ЭКГ)	Шесть отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF Анализ variability сердечного ритма (BCR) Анализ ST-сегмента. Частота сердечных сокращений Анализ и автоматическое распознавание аритмии ЭКГ-кабель на четыре электрода в комплекте	+	+
Пульсоксиметрия	Частота пульса. Насыщение артериальной крови кислородом (сатурация) SpO ₂ . Фотоплетизмограмма	+	+
Термометрия	Два канала. Измерение разности температур	+	+
Импедансный метод измерения параметров дыхания	ЧД. Респирограмма	+	+
НИАД	Сист / Сред / Диаст АД	+	+
Автоматическое внеочередное измерение АД (НИАД)	Сист / Сред / Диаст АД, время задержки волны ФПГ относительно QRS-комплекса ЭКГ	+	+
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики	CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV. Собственная технология, основанная на методе объёмно-компрессионной осцилометрии		+
Капнография в прямом потоке	EtCO ₂ , FiCO ₂ , ЧД. Капнограмма		+
Гарантийный период — 24 месяца		+	+
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов		90 000	90 000
Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория		225 000 / 1	415 000 / 1

Пульсоксиметр ОП-31

Предназначен для непрерывного длительного неинвазивного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO₂) и частоты пульса (PR) методом двухволновой оптической оксиметрии.

- Взрослые
- Дети
- Новорождённые

Дисплей: светодиодные индикаторы
Встроенный аккумулятор: не менее 5 часов работы, вход для подключения к бортсети 12 В
Поле вывода: сатурация (SpO₂), частота пульса (PR)
Тренды: цифровые
Масса прибора: 0.65 кг



Кабель подключения к бортсети 12 В	по запросу
Гарантийный период — 24 месяца	+
Доп. гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов	6 000
Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория	67 000 / 1

Измеритель инвазивный портативный электронный автономный центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма человека ИиНД 500/75

Предназначен для инвазивного однократного измерения или мониторингирования центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма человека с высокой точностью.

- Взрослые
- Дети
- Новорождённые

Дисплей: жидкокристаллический
Встроенный аккумулятор: не менее 6 часов работы
Применение: в пульмонологии для измерения давления в дыхательных путях; в неврологии, нейрореаниматологии, гастроэнтерологии и нефрологии



Диапазон измерений, мм вод. ст.	–200...450
Параметры мониторинга	Информация о системе измерения давления. Усреднённое значение давления. Мгновенное значение давления. Верхнее значение волны давления. Нижнее значение волны давления. Индикаторный столбик волны давления
Гарантийный период — 24 месяца	+
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов	6 000
Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория	110 000 / 1

ОП-31

ИиНД 500/75

Система централизованного мониторинга СЦМ «Тритон»


Возможности СЦМ

Стандартные формы для вывода на принтер: общий тренд всех цифровых параметров за сутки (реанимационная карта), общий тренд всех цифровых параметров (наркозная карта), фрагменты ЭКГ, фрагменты ЭКГ + тренды.

Встроенные журналы движения пациентов, анестезий, манипуляций, которые могут быть адаптированы для работы в любом отделении интенсивной терапии и реанимации.

Сохранение фрагментов ЭКГ, ФПГ произвольной длины на жёсткий диск с последующим просмотром, анализом и печатью.

Система центрального мониторинга объединяет в общую сеть прикроватные мониторы. Централизованный мониторинг значительно экономит время медперсонала и повышает уровень безопасности пациентов. Система может объединяться с внутрибольничной сетью.

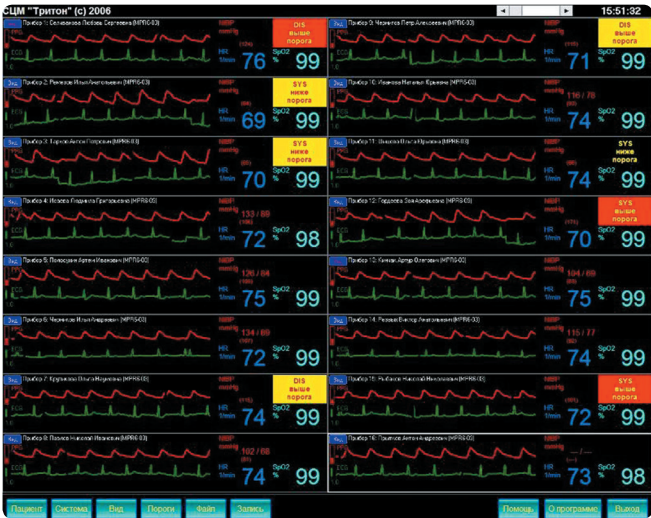

	СЦМ1.26	СЦМ2.26
Дисплей 19", отображение каждого монитора пациента в отдельном окне	+	+
Отображение цифровых значений: SpO ₂ , PR, ЧСС, T, АД, EtCO ₂ , FiCO ₂	+	+
Отображение графиков: кардиограмма (ЭКГ), капнограмма, респирограмма, фотоплетизмограмма	+	+
Лазерный принтер, источник бесперебойного питания, звуковые колонки, сетевое оборудование, программное обеспечение	+	+
Количество объединяемых в сеть мониторов пациента, шт.	до 6	до 16
Возможность расширения до 32 мониторов пациента		+
Подключение одного дополнительного монитора (свыше 16-го)		21 000
Дополнительный дисплей на центральный пост	по запросу	по запросу
Гарантийный период — 24 месяца	+	+
Дополнительный гарантийный период 12 месяцев, без учёта расходных материалов	84 000	84 000
Стоимость. НДС не облагается / ценовая категория	640 000 / 1	920 000 / 1

История разработок медицинских технологий

С 1989 года компания занимается разработками в области медицинского оборудования и технологий.

Тритон-ЭлектроникС производит модульные решения, которые используются производителями медицинских приборов в качестве готовых измерительных каналов респираторного мониторинга либо мониторинга основных параметров жизнедеятельности человека.

Более 20 000 медицинских изделий по всему миру укомплектовано нашими модульными решениями.

1989

Пульсоксиметрия

1992

Капнометрия в боковом потоке

2003

Автоматическое внеочередное измерение артериального давления (ННИАД)

2008

Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики

2010

Оценка глубины анестезии

2011

Капнометрия в прямом потоке

2013

Оценка истинных метаболических потребностей

2013

Респираторная механика

2016

Анализ анестезиологических газов (мультигаз)

2016

История создания медицинского оборудования

Прикроватные мониторы пациента, специализированные одноканальные мониторы, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции лёгких.



Содержание

Транспортный аппарат искусственной вентиляции лёгких Zisline T100	1–3
Аппарат искусственной вентиляции лёгких стационарный Zisline MV350	4–8
Аппарат искусственной вентиляции лёгких высокочастотный струйный Zisline JV100	9
Анализатор мультигазовый АМГ-06	10
Монитор оценки глубины анестезии МГА-06	11
Анестезиологический монитор пациента МПР6-03	12
Реанимационный монитор пациента МПР6-03	13–14
Реанимационный монитор пациента МПР6-03 с каналом мониторинга глубины седации	15–16
Транспортный / портативный монитор пациента МПР6-03	17
Пульсоксиметр ОП-31	18
Измеритель инвазивный портативный электронный автономный центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма человека ИиНД 500/75	18
Система централизованного мониторинга СЦМ «Тритон»	19
История разработок медицинских технологий	20
История создания медицинского оборудования	20

Мы непрерывно
совершенствуем
наши приборы
и воплощаем
в них эффективные
решения, направленные
на повышение качества
оказания медицинской
помощи пациентам



Опыт решений в обработке
биофизических сигналов,
мониторинге газообмена
и респираторной поддержке
с 1989 года

Россия, 620133,
Екатеринбург,
ул. Бажова, стр. 33

Система менеджмента качества
сертифицирована в соответствии
с требованиями стандартов
ГОСТ ISO 13485 и EN ISO 13485

Июнь
2026

